

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1342 DEL 02/12/2015

OGGETTO: FONDI FSC – 2007/2013 – INTERVENTO AMMODERNAMENTO
TECNOLOGICO - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI
VARI DESTINATI AL DISTRETTO DI OLBIA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT. SALVATORICO ORTU		DOTT. DAVID HARRIS	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 02/12/2015	Al 17/12/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

SU

Proposta del servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale.

VISTA

La “*Convenzione regolante il finanziamento alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna per la realizzazione degli interventi programmati a valere sui fondi FSC 2007-2013 assegnati con le delibere CIPE 78/2011 e 93/2012*” stipulata tra questa Azienda e La Regione Autonoma della Sardegna in data 18/12/2014, con riferimento all'intervento: “*Ammodernamento tecnologico*” con un contributo assegnato pari ad € 600.000,00.

VISTA

La deliberazione n. 1120 del 18/04/2013 mediante la quale si è provveduto alla nomina del RUP ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/2006.

VISTA

La nota 12018 del 13/11/2012 (All. 1 alla presente) mediante la quale la dott.ssa Sanna trasmetteva a questo Servizio un elenco di strumentario per gli ambulatori del Distretto di Olbia, ai fini dell'avvio della pratica volta all'assegnazione dei finanziamenti FSC 2007/2013;

PRESO ATTO CHE

nell'ambito della citata nota 12018/2012, la Dottoressa Sanna ha di recente individuato gli acquisti di beni che rivestono carattere di prioritario.

DATO ATTO E CONSIDERATO QUANTO SEGUE:

il finanziamento a disposizione non è sufficiente per l'acquisto di tutti i beni indicati, pertanto si procederà alle acquisizioni, secondo le priorità indicate, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie assegnate; il contributo stanziato per l'intero intervento “*Ammodernamento Tecnologico*” è pari ad € 600.000,00 e al momento risultano impegnati € 300.000,00 per l'acquisto dell'apparecchiatura TC 32 ed € 183.000,00 (salvo sconti o ribassi) per l'acquisto dell'apparecchiatura Cone beam;

si procederà agli acquisti sulla base delle specifiche indicate in allegato 1 alla presente e di quanto previsto nel capitolato generale d'appalto per forniture e servizi vigente presso questa Azienda;

trattasi di acquisti sotto la soglia comunitaria e quasi tutti i prodotti sono presenti sul MEPA; pertanto si procederà mediante espletamento di ODA o RDO, oppure con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 125 c. 11 del D. Lgs. 163/2006, in modalità telematica, ovvero, ove possibile, con ricorso al CAT Sardegna;

alla luce di quanto sopra esposto e al fine di ridurre al minimo i tempi per l'espletamento delle procedure per evitare la perdita dei finanziamenti comunitari (occorre, infatti, aggiudicare le procedure entro il 31/12/2015 per la maturazione dell'obbligazione giuridicamente vincolante), si procederà all'aggiudicazione definitiva con determinazioni del Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale, nel rispetto della deliberazione 1056/2015.

VISTI

il D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

la deliberazione 1056/2015.

DELIBERA

per i motivi sopra espressi,

Di autorizzare a contrarre in relazione agli acquisti descritti nell'allegato 1 alla presente, nel rispetto di quanto previsto nel capitolato generale d'appalto per forniture e servizi vigente presso questa Azienda, dando atto che si procederà all'acquisizione dei beni, secondo le priorità indicate dal Direttore del Distretto di Olbia, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie assegnate.

Di dare atto che si procederà mediante espletamento di ODA o RDO, oppure con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 125 c. 11 del D. Lgs. 163/2006, in modalità telematica, ovvero, ove possibile, con ricorso al CAT Sardegna.

Di dare atto che si procederà alle aggiudicazioni definitive con determinazioni del Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale.

Di dare atto che l'importo delle acquisizioni, che potrà essere quantificato esattamente solo in esito all'espletamento delle procedure, è finanziato con fondi del programma "Fondi FSC 2007 - 2013 " come segue: PROGETTO FSC 2007-2013_4 - Conto Attrezzature sanitarie e scientifiche A102020401.

Di dare atto che il presente provvedimento è inserito sul sistema atti amministrativi "senza impegno di spesa"; infatti in relazione all'intervento "Ammodernamento tecnologico" è stato creato un progetto dedicato cui corrisponde apposito finanziamento utilizzabile solo per l'acquisto di apparecchiature incluse nell'intervento stesso; pertanto l'impegno di spesa sarà assunto con le singole determinazioni di aggiudicazione, quando sarà noto l'effettivo importo delle forniture.

Di dare atto che il Servizio proponente il presente provvedimento è competente per gli ulteriori incombeni procedimentali.

Di comunicare il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio e all'Area Programmazione, Controllo e Committenza.

**Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme**

per il Servizio
R. Di Gennaro
MCassitta
Proposta n° 370/2015

Prot. NP/2012/12018

Olbia,


Al Direttore del Servizio Provveditorato e
 Amm.ne Patrimoniale
 Avv. Roberto Di Gennaro

Sede

OGGETTO: Rettifica richiesta strumentario Poliambulatori Distretti di Olbia
 a seguito della mail del 11.8.2015

DISTRETTO DI OLBIA

POLIAMBULATORIO DI OLBIA	
4	Sgabelli con ruote
1	Paraventii rivestiti in tessuto lavabile a 3 elementi dotato di ruote
2	Scalette omologate a 2 gradini per lettino
1	Servo mobile con 4 cassette (per ambulatorio di odontoiatria)
10	Carrelli per medicazione
1	Autoclave da banco con le seguenti caratteristiche: camera di sterilizzazione di capacità di almeno 18 lt.; dimensioni camera interna almeno 260 mm (D) per almeno 360 mm. (P) cicli di convalida; dotata di distillatore; meccanismo di bloccaporta; camera in acciaio inox; controllo del processo di sterilizzazione a microprocessore; presenza di stampante per la rendicontazione del ciclo di sterilizzazione; completa di almeno 2 carrelli porta strumenti per ogni unità; temperatura almeno fino a 134° C.; completa di allarmi di mancata pressione e acqua; sistema di sicurezza della pressione; auto-spegnimento e segnalazione acustica a fine ciclo; IN SOSTITUZIONE DI N. 1 STERILIZZATRICE CON IL SEGUENTE N. DI INVENTARIO: 000001656 ubicato presso l'ambulatorio di ORL
8	CARDIOLOGIA
2	Pinze ECG pediatriche

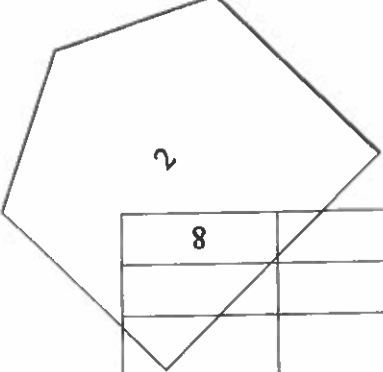

OCULISTICA	
2	Occhiali di prova per adulti tipo Oculus in metallo leggero e plastica, possibilità di inserimento di num.5 lenti di prova, regolazione distanza interpupillare da 48 a 80 mm, possibilità di regolazione della distanza dall'apice corneale, delle lunghezze e delle angolazioni, possibilità di inserimento di clip accessorie tipo filtri URGENTE- richiesta inoltrata il 26/08/2010.
2	Ottotipo per bambino con figure
1	Occhiali di prova per bambino
1	Pistoncino per tonometro di Goldman
3	Lampada a luce fredda con lente (a piantana)
2	Testine per retinoscopio
4	Ferri chirurgici con doppia sgorbia per asportazione di corpi estranei
2	Pinze congiuntivali curve URGENTE - richiesta inoltrata il 26/08/2010 -
1	Lampada a fessura <i>questo 2</i>
1	Oftalmometro con cloche a movimento unificato per il centraggio la messa a fuoco e le misurazioni. Campo di misurazione: diottrie da 30,00 a 60,00D - raggio da 5,6 a 11,3 mm, precisione 0,005 mm. Risoluzione: diottrie 0,25 D - raggio 0,05 mm.
1	Oftalmoscopio con lampadina alogena da 2,5 Volt, ottica asferica, presenza di 4-6 diaframmi, filtro verde, range di correzione da +20 a -35 D.
1	Tonometro ad appianazione completo di placca di fissaggio a lampada a fessura ed asta di taratura.
2	Lente pre-corneale Volk Superfield. Lente per la diagnosi del fondo oculare non a contatto, possibilità di esplorazione fino a 16° ingrandimento 0,76X.
3	Lente a 3 specchi
1	Retinoscopio con lampada alogena 2,5 Volt, comando unico per convergenza e rotazione, filtro polarizzazione integrato.
1	Set di stecche per Schiascopia
1	Set di ferri: - n. 2 pinze serrafili a punta piatta per punti di sutura corneale di cui 1 curva e 1 retta, - n. 1 pinza congiuntivale, - n. 2 sgorbie per rimozione di corpi estranei corneali, - n. 1 fresa/micromotore per rimozione corpi estranei con punta, - n. 1 set lavaggio vie lacrimali composto da 2 specilli a punta fine e 2 a punta media, 4 aghi per lavaggio delle vie lacrimali di cui 2 retti e 2 curvi - n. 2 serrafili rette
1	Frontofocometro a lettura interna tipo croce-corona. Alimentazione elettrica. Campo di misurazione da 0 a +/-25 D. Determinazione del potere cilindrico. Orientamento da 30 a 90 gradi.


OTR

2

le

Revista 1

1	Rinofaringoscopia flessibile (cavo a fibre ottiche 3,2 mm, 300/320 mm., adattatore)	1
1	Endoscopia rigida non autoclavabile (diam. 10 mm., 195 mm., 90°)	1
2	Bilancia pesa persona dotata di altimetro per valutare altezza persone	2
1	Otoscopia	1
5	Schizzetoni in vetro (200 MII.)	5
	DERMATOLOGIA	
	Lente di ingrandimento autoilluminante, a luce fredda fluorescente, 3 diottrie (1,75x) su piantana.	1-non urgente
	Strumentario per crioterapia con azoto liquido – serbatoio ricaricabile tipo MVE LAB; strumento per travaso azoto (rubinetto o altro); erogatore tipo CRYOPRO spray + puntali	1-urgente
1	Diatermocoagulatore con le seguenti caratteristiche tecniche: 1. funzione taglio-coagulo bland; 2.funzione coagulo forced; 3.funzione coagulo soft; 4.elevata frequenza di lavoro; 5.manuale d'uso in lingua Italiana; 6.certificazione per l'utilizzo in ambiente ambulatoriale(localidi gruppo 1); 7.completo di tutti gli accessori necessari al suo funzionamento tra cui: a. cavo di collegamento elettrodo neutro e kit elettrodi monouso assorbiti(minimo 50 pz) b.manipolo pluruso con pulsanti c.manuale operativo in lingua Italiana.	1
	PNEUMOLOGIA	
3	Bilancia con altimetro – meccanica: dotata di pedana antiscivolo e ruote per una facile movimentazione	3
1-priorità assoluta	Spirometro con le seguenti caratteristiche: apparecchio per prove di funzionalità respiratoria modulare di dimensioni e peso ridotti in grado di eseguire test di valutazione dell'apparato cardio-respiratorio secondo le più recenti e accreditate metodiche ATS/EFRS 2005.	1-priorità assoluta

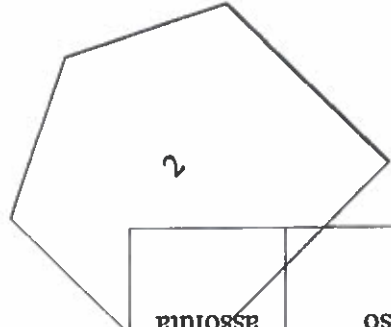

Revista 1

Ultima priorità


Assistenza urgente

Revista 1

<p>Possibilità di aggiornare la propria configurazione ad una delle eventuali superiori. Il modulo deve anche contenere al suo interno i componenti principali. I moduli configurabili dovrebbero essere rappresentati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modulo per spirometria (per spirometria – FVC, SVC, MMV e test di broncoprovocazione); • modulo per volumi polmonari (misurazione della capacità funzionale residua); • moduli per test DLCO (combina la spirometria con il test di diffusione alveolo-capillare). <p>Integrabili successivamente con:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. modulo dosimetrico; 2. modulo per la meccanica respiratoria; 3. modulo per test da sforzo. 	<p>1</p> <p><i>Altezza</i></p>	<p>Apparecchio per dosaggio emogasanalisi con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema portatile palmare di emogasanalizzatore; • dotato di display, tastiera e lettore di codici a barre integrato; • utilizzo di cartucce mono-uso/mom-paziente – dovranno essere comprese al momento dell'acquisto in quantità adeguata all'attività; • esecuzione sullo stesso strumento di test gaseumatici – chimica clinica-coagulazione-markers-cardiaci; • metodica di calibrazione automatica ad ogni test; • memorizzazione di un elevato numero di test pazienti; • sistema privo di manutenzione; • alimentazione tramite batterie ricaricabili o usa e getta; • dotato di stampante; • collegamento per lo scarico dei dati in rete; • misurazione di PH PO2, PCO2, HB, SAT, HC03, CL, Na, K, Ca, anion gap, marker cardiaci, elettroliti, glucosio. 	<p>POLIAMBULATORIO DI BERCHIDA</p> <p>OCULISTICA</p> <p>Autorefrattometro con acquisizione delle misure in qualità completamente automatica su entrambi gli occhi. Possibilità di misurazione che si estende nei valori sferici da -20D a +22D e nei cilindrici da -10D a +10D.</p> <p>Lente -3sf +0,75 cil +0,50 cil 2</p> <p>Lente -1cil +1,25 sf 1</p> <p>Carrello di medicazione 1</p> <p>CARDIOLOGIA</p> <p>Carrello per medicazione</p> <p>Carrello porta-elettrocardiografo</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>2</p>
---	--------------------------------	---	---	--	----------

ve


urgenti

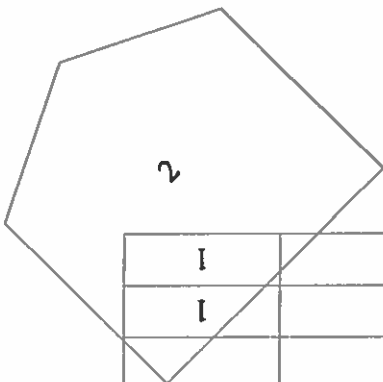

POLIAMBULATORIO DI OSCHIRI	
	CARDIOLOGIA
1	Letino cardiologico in legno omologato per dimensione (dimens. $\geq 85 \times 190$ cm.)
1	Scaletta per accesso lettino
1	Carrello per medicazione
1	Elettrocardiografo a 6 derivazioni
1	Carrello porta-elettrocardiografo

POLIAMBULATORIO DI LA MADDALENA

Q.tà	Strumento/apparecchiatura	OCULISTICA
2	Montatura di prova per adulti tipo Oculus Universal - <i>URGENTE - richiesta inoltrata il 26/08/2010 e successivamente sollecitata</i>	
1	Montatura di prova per bambini tipo Oculus Universal <i>URGENTE - richiesta inoltrata il 26/08/2010 e successivamente sollecitata</i>	
1	Ottotipo per lontano a proiezione <i>richiesta inoltrata il 26/08/2010</i>	
2	Lente di Volk da 90 diottrie <i>richiesta inoltrata il 26/08/2010</i>	
1	Lente per gonioscopia di Zeiss o di Posner	
1	Lente a 3 specchi di Goldmann da 90 D.	
2	Pinze serrafili rette <i>URGENTE - richiesta inoltrata il 26/08/2010</i>	
2	Pinze serrafili curve <i>URGENTE - richiesta inoltrata il 26/08/2010</i>	
1	Pinza per depilazione <i>URGENTE - richiesta inoltrata il 26/08/2010</i>	
2	Set di aghi curvi per lavaggio delle vie lacrimali <i>URGENTE - richiesta inoltrata il 26/08/2010</i>	
2	Set di aghi retti per lavaggio delle vie lacrimali <i>URGENTE - richiesta inoltrata il 26/08/2010</i>	
3	Specilli medi per dilatazione dei puntini lacrimali <i>URGENTE - richiesta inoltrata il 26/08/2010</i>	
3	Specilli fini per dilatazione dei puntini lacrimali <i>URGENTE - richiesta inoltrata il 26/08/2010</i>	
1	Frontofocometro elettronico URGENTE - <i>richiesta inoltrata il 26/08/2010 - di cui si allegano caratteristiche tecniche</i>	
1	Autorefrattometro URGENTE - <i>richiesta inoltrata il 26/08/2010 - di cui si allegano caratteristiche tecniche</i>	

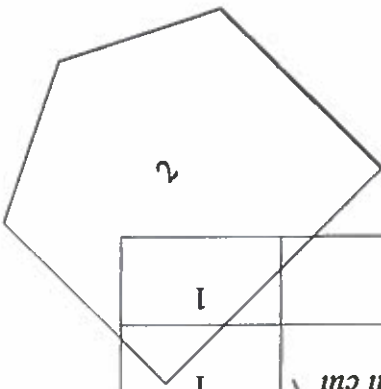


3
2-2

Handwritten signature or mark

1	Tavolo gemellare con lampada a fessura tipo Haag Streit URGENTE - richiesta inoltrata il 26/08/2010 - di cui si allegano caratteristiche tecniche	1
1	Sistema di acquisizione di immagini	1
1	Lampada a fessura Haag Streit - di cui si allegano le caratteristiche tecniche	1
1	Oftalmometro URGENTE - richiesta inoltrata il 26/08/2010 -	1
	O.R.L.	
1	Caschetto a fibre ottiche e fonte luminosa	1
10+10	Specchietti laringei Ø mm. 26, mm. 25	
10	Cannule per aspiratore chirurgico del tipo Frazier Ø mm.2	
10	Cannule per aspiratore chirurgico del tipo Frazier Ø mm.3	
10	Cannule per aspiratore chirurgico del tipo Frazier Ø mm.4	
10	Cannule per aspiratore chirurgico del tipo Frazier Ø mm.5	
10	Pinza a baionetta lucae (non dentata)	
4	Pinza auricolare Hartman	
	DERMATOLOGIA	
	<i>Novità 1</i>	
1	Lente di ingrandimento autoilluminante, a luce fredda fluorescente, 3 diottrie (1,75x) su piantana.	1
1	Strumentario per crioterapia con azoto liquido - serbatoio ricaricabile tipo MVE LAB; strumento per travaso azoto (rubinetto o altro); erogatore tipo CRYOPRO spray + puntali	1
1	Dermatoscopio con testina e manico ricaricabile 3,5 Volts, ingrandimento 10X, vetrino di contatto con scala millimetrata	1
1	Sigillatrice con rotoli di varie misure	1
3	Carrelli per l'emergenza (necessari ai fini dell'accreditamento istituzionale)	3

POLIAMBULATORIO DI S.TERESA DI G.


Strumento/apparecchiatura	Autoclave da banco con le seguenti caratteristiche: camera di sterilizzazione di capacità di almeno 18 lt.; dimensioni camera interna almeno 260 mm (D) per almeno 360 mm. (P) cicli di convalida; dotata di distillatore; meccanismo di bloccaporta; camera in acciaio inox; controllo del processo di sterilizzazione a microprocessore; presenza di stampante per la rendicontazione del ciclo di sterilizzazione; completa di almeno 2 carrelli porta strumenti per ogni unità; temperatura almeno fino a 134° C.;	1
Q.tà		1

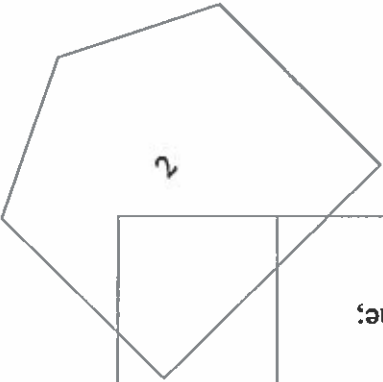

<ul style="list-style-type: none"> • completa di allarmi di mancata pressione e acqua; • sistema di sicurezza della pressione; • auto-spegnimento e segnalazione acustica a fine ciclo; 	<ul style="list-style-type: none"> • completa di allarmi di mancata pressione e acqua; • sistema di sicurezza della pressione; • auto-spegnimento e segnalazione acustica a fine ciclo;
<ul style="list-style-type: none"> • IN SOSTITUZIONE DI N. 2 STERILIZZATRICI CON IL SEGUENTE N. DI INVENTARIO: • 000001378 ubicato presso l'ambulatorio di ORL • 2820 23257 ubicato presso l'ambulatorio di Ginecologia 	
O.R.L.	
10+10	Specchietti laringei Ø mm. 26, mm. 25
10	Cannule per aspiratore chirurgico del tipo Frazier Ø mm.2
10	Cannule per aspiratore chirurgico del tipo Frazier Ø mm.3
10	Cannule per aspiratore chirurgico del tipo Frazier Ø mm.4
10	Cannule per aspiratore chirurgico del tipo Frazier Ø mm.5
10	Pizza a baionetta lucae (non dentata)
4	Pizza auricolare Hartman
	OCULISTICA -vedi caratteristiche tecniche allegate-
1	Tavolo elettrico gemellare ad elevazione elettrica piano traslabile per 2 strumenti
1	Oftalmometro secondo Javal
1	Lampada a fessura
1	Autorefrattometro completamente automatico
1	Frontofocometro digitale completo di stampante e lettura lenti progressive

<ul style="list-style-type: none"> • camera di sterilizzazione di capacità di almeno 18 lt; • dimensioni camera interna almeno 260 mm (D) per almeno 360 mm. (P) • cicli di convalida; • dotata di distillatore; • meccanismo di bloccaporta; • camera in acciaio inox; • controllo del processo di sterilizzazione a microprocessore; • presenza di stampante per la rendicontazione del ciclo di sterilizzazione; • completa di almeno 2 carrelli porta strumenti per ogni unità; • temperatura almeno fino a 134° C; • completa di allarmi di mancata pressione e acqua; • sistema di sicurezza della pressione; • auto-spegnimento e segnalazione acustica a fine ciclo. 	<ul style="list-style-type: none"> • camera di sterilizzazione di capacità di almeno 18 lt; • dimensioni camera interna almeno 260 mm (D) per almeno 360 mm. (P) • cicli di convalida; • dotata di distillatore; • meccanismo di bloccaporta; • camera in acciaio inox; • controllo del processo di sterilizzazione a microprocessore; • presenza di stampante per la rendicontazione del ciclo di sterilizzazione; • completa di almeno 2 carrelli porta strumenti per ogni unità; • temperatura almeno fino a 134° C; • completa di allarmi di mancata pressione e acqua; • sistema di sicurezza della pressione; • auto-spegnimento e segnalazione acustica a fine ciclo.
1	Autoclave da banco con le seguenti caratteristiche:
Q.tà	Strumento/apparecchiatura

POLIAMBULATORIO DI ARZACHENA

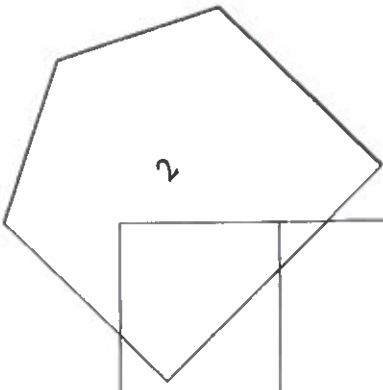


3	Carrelli per l'emergenza (necessari ai fini dell'accreditamento istituzionale)
2	Letino da visita in legno (dimens. ≥ 85 x 190 cm.)
	OCULISTICA (URGENTE - richiesta inoltrata il 26/08/2010)
1	Montatura di prova per adulti tipo Oculus Universal
1	Montatura di prova per bambini Oculus Universal
1	Frontofocometro digitale completo di stampante per lettura anche di lenti progressive
1	Ottotipo con figure per bambini
1+1	Retinoscopio (testina e manico)
1+1	Oftalmoscopio (testina e manico)
2	Pinze per ciglia di Barraquer
3	Specilli per apertura del puntino lacrimale di diverse dimensioni
2	Aghi curvi per lavaggio vie lacrimali di diverso calibro
2	Testine rimovibili per fresa a pile (mod. Algebrush II)
2	Pinze congiuntivali curve
1	Pinza congiuntivale retta

DISTRETTO DI TEMPIO PAUSANIA

In riferimento alla nota RAS in oggetto ed alla e-mail del Servizio Provveditorato Aziendale, si ritiene prioritario, come già più volte evidenziato, l'acquisto di un Ecografo Digitale Compatto, di ultima generazione, per un'ampia gamma di applicazioni (Cardiologiche, Reumatologiche, Endocrinologiche, Urologiche e Dermatologiche).

Il suo acquisto garantirebbe, all'utenza, una appropriata assistenza ed una diagnosi completa nella stessa seduta, evitando il ricorso a strutture ospedaliere intra ma spesso extra-ASL con ritardi diagnostico-terapeutici. Si eviterebbe così la congestione dei Servizi di 2° Livello e contestualmente si ridurrebbero le Liste d'Attesa delle relative branche specialistiche. Si allegano schede tecniche esemplificative. Il costo totale dell'ecografo più sonde si aggira su 45-50.000 Euro.

Nel caso vi fossero dei residui si chiede di dar seguito alle richieste di:
 Porta lenti pediatrici, arredi quali paravento per le sale visite, predelline, lampade scialitiche etc.
 come nell'ultima nota del 6/11/2012 (consegnato alla Dott.ssa Nuomo).

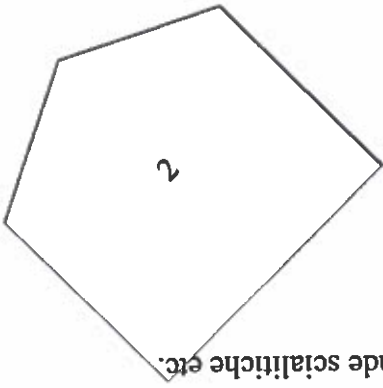

Distinti saluti.

Il Direttore del Distretto di Tempio P.
(Dott.ssa Anna Manconi)

Il Responsabile del Distretto di Olbia
(Dott.ssa Anna Maria Sanna)

cc

