

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
Olbia

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 913 DEL 29.04.2010

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA IN REGIME DI SERVICE DI BENI, LAVORI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE CLINICHE DEL LABORATORIO DI EMODINAMICA DELL'UNITÀ OPERATIVA DI CARDIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OLBIA.

L'anno duemiladieci il giorno Ventinove del mese di aprile in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

IL COMMISSARIO

Dott. Giovanni Antonio Fadda

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Avv. Mario Giovanni Altana

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Maria Serena Fenu

PREMESSO QUANTO SEGUE:

1. Con propria deliberazione n. 1365 del 28/12/2009:
 - è stato autorizzato l'espletamento della procedura aperta di rilievo comunitario ai sensi degli artt. 54 e 3 comma 37 del D.lgs 163/2006, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 dello stesso decreto, per la fornitura in regime di service di beni, lavori e servizi per la gestione delle procedure cliniche del Laboratorio di Emodinamica dell'U.O. di Cardiologia del P.O. di Olbia, per il periodo di cinque anni con opzione di rinnovo per un ulteriore triennio;
 - è stato approvato il Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati;
2. Il bando di gara ha avuto adeguata pubblicità mediante pubblicazione su:
 - Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea (29/12/2009), Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (30/12/2009), Gazzetta Aste ed Appalti pubblici, sui quotidiani nazionali e locali, Inserzione sul sito internet Ministero delle infrastrutture, Inserzione sul sito internet dell'Osservatorio dell'Autorità di Vigilanza, Inserzione sul sito internet aziendale, presso quest'ultimo sono stati altresì pubblicati il disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati, avvisi e risposte a richieste successive di chiarimenti;
3. Nel predetto bando veniva precisato che le offerte sarebbero dovute pervenire non oltre il giorno 26/02/2010 e che la prima seduta pubblica era fissata per il giorno 03/03/2010 alle ore 09:30 presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;
4. Con propria deliberazione n.106 del 21/01/2010 sono state autorizzate alcune rettifiche al Capitolato speciale d'appalto e pertanto alcuni termini previsti dal bando, tra cui quello di scadenza per la presentazione delle offerte, e la data della seduta pubblica sono stati rinviati rispettivamente al 12/03/2010 e al 17/03/2010 ore 09:30;
5. Con propria deliberazione n. 566 del 16/03/2010 è stata nominata la Commissione giudicatrice delle offerte;
6. La procedura aperta è stata espletata come da verbali del 17/03/2010, del 13/04/2010, del 16/04/2010 e del 26/04/2010, allegati al presente provvedimento, di cui si condividono i contenuti, da cui risulta che il RTI - Medical Spa + Kardias Srl, unica offerente, è risultata aggiudicataria provvisoria della fornitura in oggetto. Il prezzo complessivo annuo della fornitura è di € 1.750.370,00 Iva esclusa, così suddiviso:
 - Costi procedure (stima) € 796.850,00 Iva 20% esclusa (salvo che trattasi di componenti con Iva agevolata quali ad esempio gli stent)
 - Costo canone nolo apparecchiature, attrezzature, arredi ecc, D.P.I., hardware e licenze software € 510.960,00 Iva 20% esclusa
 - Costo lavori completamento locali chiavi in mano € 174.000,00 Iva 10% esclusa
 - Costo totale dei servizi € 268.560,00 Iva 20% esclusa
7. I locali destinati all'emodinamica si trovano nel padiglione D2 dell'Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia in fase di realizzazione; pertanto, si prevede che l'attività operatoria possa iniziare nel mese di gennaio 2011;

SU

conforme proposta, del Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione patrimoniale;

VISTI

il D.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L. R. n. 10 del 24 marzo 1997 "Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Sanitarie Regionali, modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 5, e abrogazione della legge regionale 8 luglio 1981, n. 19", e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.Lgs. n.163 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modificazioni ed integrazioni;
la L. R. n. 10 del 28 luglio 2006 "Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26/01/1995, n. 5";

DELIBERA


Per quanto esposto in premessa:

- di approvare gli atti della procedura aperta descritti in premessa ed in particolare i verbali del 17/03/2010, del 13/04/2010, del 16/04/2010 e del 26/04/2010, allegati al presente provvedimento;
- pertanto, di aggiudicare definitivamente l'appalto di che trattasi al costituendo RTI - Medical Spa + Kardia Srl, per un prezzo complessivo annuo della fornitura è di € 1.750.370,00 Iva esclusa, e per un prezzo complessivo relativo al quinquennio di durata contrattuale pari ad € 8.751.850,00 Iva esclusa, dando atto che i costi del materiale per le procedure saranno pagati esclusivamente nei limiti dell'effettivamente consumato; la relativa spesa graverà sulle spese correnti di bilancio e sarà imputato al centro di costo POA 01.15.01;
- di dare atto che la relativa spesa, considerata la data presunta di inizio attività operatoria, è così presuntivamente ripartita nell'arco del quinquennio di durata contrattuale: anno 2011 - € 1.750.370,00 Iva esclusa, anno 2012 - € 1.750.370,00 Iva esclusa, anno 2013 - € 1.750.370,00 Iva esclusa, anno 2014 - € 1.750.370,00 Iva esclusa, anno 2015 - € 1.750.370,00 Iva esclusa;
- il presente provvedimento è soggetto a controllo regionale ai sensi dell'art. 29 della L.R. n.10/2006 e pertanto esso deve essere trasmesso all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell' Assistenza sociale.

Letto, confermato e sottoscritto


IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Maria Serena Fenu




IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Avv. Mario Giovanni Altana



IL COMMISSARIO

Dott. Giovanni Antonio Fadda



per il Servizio
avv. R. di Gennaio

T.Soro
Proposta 257/2010



da compilarsi a cura del Servizio/Struttura proponente/estensore

(luogo e data) Olbia ___/___/___.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale n. 10 del 28.7.2006

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ (proponente/estensore)
(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 06/05/2010, e che:

... è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data 06/05/2010, protocollo n. PG/2010/24622, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 06/05/2010

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio DIR. GEN. SANITÀ AFFARI GENER. E ISTIT dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. 419 del 17/05/2010.

... è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ___/___/___.

... è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 24/5/2010.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso _____.

Olbia, ___/___/___.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

VERBALE DI GARA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN REGIME DI SERVICE DI BENI, LAVORI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE CLINICHE DEL LABORATORIO DI EMODINAMICA DELL'UNITÀ OPERATIVA DI CARDIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OLBIA.

L'anno 2010, il giorno 26 del mese di aprile, alle ore 09:50 in seduta pubblica presso gli uffici del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 - 1° piano - Via Bazzoni Sircana, n. 2/2A - Olbia, è riunita la commissione, appositamente nominata dalla stazione appaltante con deliberazione del Commissario n. 566 del 16/03/2010, così composta:

- **Avv. Roberto Di Gennaro - Direttore Servizio Provveditorato e amministrazione patrimoniale dell'Asl Olbia - Presidente**
- **Dott. Pierfranco Terrosu - Dirigente S.C. Cardiologia P.O. di Sassari - Componente Commissione**
- **Dott. Michele Portoghese - Responsabile U.O. Cardiocirurgia di Sassari - Componente Commissione**
- **Ing. Roberto Manca - Dirigente ufficio tecnico Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari - Componente Commissione**
- **Dott. Cesare Delussu - Responsabile del servizio informativo sanitario ed amministrativo dell'Asl Olbia - Componente Commissione**

Segretario verbalizzante: dott.ssa Tiziana Soro

Sono presenti il sig. Leonardo Fiore e il sig. Gianni Demelas per il RTI - Medical Spa + Kardia Srl.

Richiamate le operazioni di gara di cui ai precedenti verbali del 17/03/2010, del 13/04/2010 e del 16/04/2010, si comunicano gli esiti della valutazione del progetto tecnico come riportate nel verbale del 16/04/2010. Indi si fa constare dell'integrità del plico contenente l'offerta economica e si procede alla sua apertura.

L'offerta economica risulta regolare e completa.

Il prezzo complessivo annuo della fornitura è pari ad € 1.750.370,00 Iva esclusa, così suddiviso:

€ 796.850,00 per costi procedure

€ 510.960,00 per canoni nolo

€ 174.000,00 per lavori

€ 268.560,00 per costi totali servizi

Trattandosi di un'unica offerta ad essa deve essere attribuito il massimo del punteggio (38 punti).

Pertanto il punteggio complessivo è pari a 95/100 ed in entrambi i criteri di valutazione (qualità e prezzo) il punteggio attribuito è superiore ai 4/5 del massimo.

Applicando il metodo matematico previsto dall'art. 86 comma 2 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., dovrebbe essere valutata la congruità dell'offerta.

Tuttavia la Commissione:



A) considerato:

- che è evidente la *ratio* della previsione normativa: di norma, a maggiore qualità corrisponde un prezzo più elevato; pertanto, in astratto, si può ritenere che sia bene porre attenzione alle offerte che conseguono alti punteggi sia sulla qualità sia sul prezzo;
- che la verifica di congruità è un processo logico;
- che un'offerta individuata applicando un metodo matematico non necessariamente farà sorgere dubbi sulla sua congruità ad un esame logico (il caso più palese si ha proprio in presenza di un'unica offerta, alla quale inevitabilmente viene attribuito il massimo del punteggio per il prezzo);

B) Il ribasso è inferiore, complessivamente considerato, all'8% rispetto al prezzo a base d'asta.

C) Anche rispetto alle singole voci di costo non vi sono ribassi particolarmente significativi rispetto alle stime dell'Amministrazione.

Reputa congrua l'offerta del RTI.

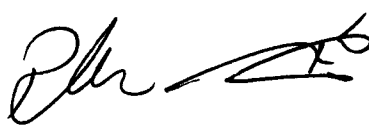


pag. 1/2

Pag. 2 Segue - VERBALE DI GARA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN REGIME DI SERVICE DI BENI, LAVORI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE CLINICHE DEL LABORATORIO DI EMODINAMICA DELL'UNITÀ OPERATIVA DI CARDIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OLBIA


I plichi contenenti la documentazione relativa alla gara in oggetto vengono consegnati al segretario verbalizzante. Quindi la Commissione, avendo concluso i propri lavori, rassegna gli atti al Servizio Provveditorato e Amministrazione patrimoniale per quanto di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto

Presidente (avv. R. di Genaro)




Componente Commissione (dott. P. Terrosu)




Componente Commissione (dott. M. Portoghese)




Componente Commissione (ing. R. Manca)



Componente Commissione (dott. C. Delussu)



Segretario (dott.ssa T. Soro)



26/04/2010

VERBALE DI GARA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN REGIME DI SERVICE DI BENI, LAVORI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE CLINICHE DEL LABORATORIO DI EMODINAMICA DELL'UNITÀ OPERATIVA DI CARDIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OLBIA.

L'anno 2010, il giorno 17 del mese di marzo, alle ore 09:45 in seduta pubblica presso gli uffici del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 - 2° piano - Via Caduti sul Lavoro, n. 35 - Olbia, è riunita la commissione, appositamente nominata dalla stazione appaltante con deliberazione del Commissario n. 566 del 16/03/2010, così composta:

- Avv. Roberto di Gennaro - Direttore Servizio Provveditorato e amministrazione patrimoniale dell'Asl Olbia - **Presidente**
- Dott. Pierfranco Terrosu - Dirigente S.C. Cardiologia P.O. di Sassari - **Componente Commissione**
- Dott. Michele Portoghese - Responsabile U.O. Cardiochirurgia di Sassari - **Componente Commissione**
- Ing. Roberto Manca - Dirigente ufficio tecnico Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari - **Componente Commissione**
- Dott. Cesare Delussu - Responsabile del servizio informatico sanitario ed amministrativo dell'Asl Olbia - **Componente Commissione**

Segretario verbalizzante: dott.ssa Tiziana Soro

È altresì presente il sig. Leonardo Fiore rappresentante della ditta Medical Spa.

I componenti della commissione di gara confermano di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 84, comma 4, 5 e 7 del D. lgs 163/2006, come da dichiarazione agli atti ;

PREMESSO:

- che con deliberazione del Commissario n. 1365 del 28/12/2009 è stato autorizzato l'espletamento della procedura aperta di rilievo comunitario ai sensi degli artt. 54 e 3 comma 37 del D.lgs 163/2006, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 dello stesso decreto, per la fornitura in regime di service di beni, lavori e servizi per la gestione delle procedure cliniche del Laboratorio di Emodinamica dell'U.O. di Cardiologia del P.O. di Olbia;

che si è provveduto, ai sensi del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006, alla pubblicazione sulla "Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea", "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana", "Gazzetta Aste ed Appalti pubblici", sui quotidiani "Italia Oggi", "Il Sardegna", "L'Unione Sarda", ed "Inserzione sul sito internet Ministero delle infrastrutture", "Inserzione sul sito internet dell'Osservatorio dell'Autorità di Vigilanza" del bando di gara relativo alla gara in oggetto;

che in detto bando veniva comunicato che le offerte dovevano pervenire all' A.S.L. n. 2 - via Caduti sul lavoro, n. 35 - 07026 Olbia, non oltre le ore 12:30 del giorno 26/02/2010 e che la prima seduta pubblica era fissata per il giorno 03/03/2010 alle ore 09:30;

che con deliberazione del Commissario n.106 del 21/01/2010 sono state autorizzate alcune rettifiche al Capitolato speciale d'appalto e che pertanto il termine di scadenza per la presentazione delle offerte e la data della seduta pubblica, sono state rinviate rispettivamente al 12/03/2010 ore 12:30 e al 17/03/2010 ore 09:30;

- che non è necessario procedere al sorteggio per la verifica di cui all'art. 48 del D.lgs. 163/2006 essendo pervenuta una sola offerta che sarà assoggettata a verifica;

- che in atti di gara si è prevista la possibilità di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida;

Pag. 2 segue -VERBALE DI GARA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN REGIME DI SERVICE DI BENI, LAVORI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE CLINICHE DEL LABORATORIO DI EMODINAMICA DELL'UNITÀ OPERATIVA DI CARDIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OLBIA.

TUTTO CIÒ PREMESSO

La Commissione, dato atto che nel termine predeterminato (11/03/2010) è pervenuto all'Ufficio Protocollo Generale ed è stato trasmesso da questo alla Commissione il plico del RTI - Medical Spa + Kardia Srl - unico offerente, procede all'apertura del plico fino a questo momento ancora sigillato e alla verifica della documentazione amministrativa ivi contenuta; all'esito della verifica, essendo la documentazione regolare, dispone l'ammissione dell'RTI; trattasi di RTI di tipo verticale che si riserva di subappaltare i "Servizi di ingegneria (Progettazione, Direzione Lavori, coordinamento per la sicurezza), parte delle opere edili ed impiantistiche, parte dell'assistenza tecnica ai centri di assistenza autorizzati dai produttori delle tecnologie e che la percentuale delle prestazioni che intende subappaltare è il 10%;

Si da atto che nel plico è contenuta altresì la documentazione tecnica e la busta contenente l'offerta economica, sigillata.

La commissione, deciso di iniziare l'esame della documentazione tecnica, esame che è previsto si debba svolgere in sedute riservate, dichiara chiusa la seduta pubblica e comunica al rappresentante della RTI offerente che con seguente nota verrà data comunicazione dell'eventuale successiva seduta pubblica per l'apertura dell'offerta economica e lo invita ad uscire dalla sala.

Il sig. Leonardo Fiore rappresentante della ditta Medical Spa esce dalla sala alle ore 10:30.


Indi si inizia la verifica della documentazione tecnica.

La Commissione prosegue in seduta riservata, sino alle ore 13:00, alla verifica della documentazione tecnica presentata dall' RTI - Medical Spa + Kardia Srl - al fine di poter valutare la qualità del progetto proposto. A quell'ora, non essendosi concluso l'esame della documentazione tecnica, la seduta viene aggiornata a giorno ed ora da definirsi.


I plichi contenenti la documentazione relativa alla gara in oggetto vengono custoditi in luogo sicuro presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione patrimoniale, sotto la responsabilità del segretario verbalizzante.

Letto, firmato e sottoscritto


Presidente (av. R. di Gennaro)




Componente Commissione (dott. P. Terrosu)




Componente Commissione (dott. M. Portoghese)



Componente Commissione (ing. R. Manca)



Componente Commissione (dott. C. Delussu)



Segretario (dott.ssa T. Soro)



17/03/2010

pag. 2/2

VERBALE DI GARA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN REGIME DI SERVICE DI BENI, LAVORI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE CLINICHE DEL LABORATORIO DI EMODINAMICA DELL'UNITÀ OPERATIVA DI CARDIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OLBIA.

L'anno 2010, il giorno 13 del mese di aprile, alle ore 09:30 in seduta riservata presso gli uffici del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 - 1° piano - Via Caduti sul Lavoro, n. 35 - Olbia, è riunita la commissione, appositamente nominata dalla stazione appaltante con deliberazione del Commissario n. 566 del 16/03/2010, così composta:

- Avv. Roberto Di Gennaro - Direttore Servizio Provveditorato e amministrazione patrimoniale dell'Asl Olbia - **Presidente**
- Dott. Pierfranco Terrosu - Dirigente S.C. Cardiologia P.O. di Sassari - **Componente Commissione**
- Dott. Michele Portoghese - Responsabile U.O. Cardiocirurgia di Sassari - **Componente Commissione**
- Ing. Roberto Manca - Dirigente ufficio tecnico Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari - **Componente Commissione**
- Dott. Cesare Delussu - Responsabile del servizio informativo sanitario ed amministrativo dell'Asl Olbia - **Componente Commissione**

Segretario verbalizzante: dott.ssa Tiziana Soro

PREMESSO:

- che come risulta dal verbale del 17/03/2010, previo accertamento della regolarità dei documenti, veniva ammesso alla fase successiva di gara il RTI - Medical Spa + Kardia Srl, unico offerente;
- che la Commissione di gara, avviata in seduta riservata la valutazione della documentazione tecnica presentata dal RTI e non essendo stato possibile concludere tale valutazione, ha dichiarato chiusa la seduta alle ore 13:00 ed ha aggiornato la seduta a giorno e ora da definirsi;
- che con nota del 22/03/2010 Prot. n. PG/2010/15090 è stato chiesto al RTI - Medical Spa + Kardia Srl di dimostrare, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 163/2006, il possesso dei requisiti richiesti nel disciplinare di gara e oggetto di dichiarazioni sostitutive in offerta, parte amministrativa;



TUTTO CIÒ PREMESSO

La Commissione, accertato che la documentazione acquisita ai sensi dell'art. 48 del D.lgs 163/2006 pervenuta (Prot. n. 16929 del 30/03/2010) nei termini perentori assegnati risulta essere regolare, riprende l'esame del progetto tecnico del RTI - Medical Spa + Kardia Srl, visionando i relativi volumi.

La Commissione ultimato un primo esame generale del progetto tecnico concerta che, in relazione ai criteri di attribuzione dei punteggi, siano relatori:

- il Dott. Pierfranco Terrosu e il Dott. Michele Portoghese per le parti relative alle caratteristiche tecnico funzionali delle apparecchiature, alla qualità dei dispositivi medici e materiale di consumo, alla rispondenza del servizio offerto rispetto alle esigenze del reparto
- l'Ing. Roberto Manca per la parte relativa ai lavori di completamento dei locali incluso progetto arredi
- il Dott. Cesare Delussu per la parte relativa alle prestazioni relative al software di refertazione, gestione magazzino e statistiche e all'adeguatezza dei relativi supporti hardware
- l'avv. Roberto Di Gennaro per l'assistenza tecnica, gestione del magazzino, tempi di consegna per il ripristino delle scorte

e che i relatori si impegnano tutti a relazionare la Commissione alla prossima seduta, concordando che essa si terrà in Sassari il giorno 16/04/2010 ore 15:30.



pag. 1/2

Pag. 2 segue - VERBALE DI GARA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN REGIME DI SERVICE DI BENI, LAVORI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE CLINICHE DEL LABORATORIO DI EMODINAMICA DELL'UNITÀ OPERATIVA DI CARDIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OLBIA.

Infine, essendo già possibile, la Commissione attribuisce, in base ai criteri matematici predeterminati, il punteggio relativo alle condizioni contrattuali così come previsto nel disciplinare di gara:


DITTA	ACCETTAZIONE CLAUSOLA PAGAMENTI (punti 1)	TERMINE PAGAMENTO (max punti 3)	TOTALE CONDIZIONI CONTRATTUALI
RTI - Medical Spa + Kardia Srl	SI	90 GG	Punti 4

La Commissione dichiara chiusa la seduta alle ore 12:30. in corso di seduta sono state fatte copie per i vari relatori delle parti dell'offerta tecnica di interesse.


I plichi contenenti la documentazione relativa alla gara in oggetto vengono custoditi in luogo sicuro presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione patrimoniale, sotto la responsabilità del segretario verbalizzante

Letto, firmato e sottoscritto

Presidente (avv. R. Di Gemaro)




Componente Commissione (dott. P. Terrosu)




Componente Commissione (dott. M. Portoghese)



Componente Commissione (ing. R. Manca)



Componente Commissione (dott. C. Delussu)



Segretario (dott.ssa T. Soro)



13/04/2010

VERBALE DI GARA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN REGIME DI SERVICE DI BENI, LAVORI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE CLINICHE DEL LABORATORIO DI EMODINAMICA DELL'UNITÀ OPERATIVA DI CARDIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI OLBIA.

L'anno 2010, il giorno 16 del mese di aprile, alle ore 15:30 in seduta riservata presso l'Ospedale SS. Annunziata in Sassari, è riunita la commissione, appositamente nominata dalla stazione appaltante con deliberazione del Commissario n. 566 del 16/03/2010, così composta:

- **Avv. Roberto Di Gennaro - Direttore Servizio Provveditorato e amministrazione patrimoniale dell'Asl Olbia - Presidente**
- **Dott. Pierfranco Terrosu - Dirigente S.C. Cardiologia P.O. di Sassari - Componente Commissione**
- **Dott. Michele Portoghese - Responsabile U.O. Cardiocirurgia di Sassari - Componente Commissione**
- **Ing. Roberto Manca - Dirigente ufficio tecnico Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari - Componente Commissione**
- **Dott. Cesare Delussu - Responsabile del servizio informativo sanitario ed amministrativo dell'Asl Olbia - Componente Commissione**

Segretario verbalizzante: dott.ssa Tiziana Soro

Richiamate le operazioni di gara di cui ai precedenti verbali del 17/03/2010 e del 13/04/2010, riprende l'esame del progetto tecnico.

Ciascun relatore illustra agli altri, per la parte di propria competenza, le caratteristiche dell'offerta tecnica, che vengono verificate. Infine la Commissione attribuisce i relativi punteggi qualitativi come di seguito riportato:

RTI - Medical Spa + Kardia Srl	
CRITERI	PUNTI
a) Qualità apparecchiature, arredi e dotazioni strumentali accessorie e lavori di completamento dei locali	22
b) Qualità dei dispositivi medici e materiale di consumo	15
c) Qualità della gestione del servizio proposto e dell'assistenza tecnica	16
TOTALE	53


indi dichiara che il punteggio complessivo e comprensivo anche dei punti attribuiti alle condizioni contrattuali è il seguente:

DITTA	QUALITÀ E VALORE TECNICO	CONDIZIONI CONTRATTUALI	TOTALE
RTI - Medical Spa + Kardia Srl	53	4	57

La Commissione ritiene opportuno annotare a verbale i giudizi sintetici sull'offerta riferiti ai criteri a), b) e c); essi risultano da quattro allegati:

- caratteristiche tecnico funzionali delle apparecchiature e alla qualità dei dispositivi medici e materiale di consumo ("Allegato n. 1 al verbale del 16/04/2010")
- lavori di completamento dei locali ("Allegato n. 2 al verbale del 16/04/2010")
- prestazioni relative al software di refertazione, gestione magazzino e statistiche e all'adeguatezza dei relativi supporti hardware ("Allegato n. 3 al verbale del 16/04/2010")


Sede legale e Direzione Generale
Via Caduti sul Lavoro n. 35


Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale
Via Caduti sul Lavoro n. 35 - tel. 0789/552327 -
fax 0789/67645


- qualità della gestione del servizio proposto e dell'assistenza tecnica ("Allegato n. 4 al verbale del 16/04/2010")

Quindi i componenti della Commissione concordano che la successiva seduta pubblica per l'apertura dell'offerta economica si svolga il giorno 26/04/2010 ore 09:30, dando atto che si dovrà procedere a preavvertire della seduta l'offerente con le modalità previste nel disciplinare di gara.


I plichi contenenti la documentazione relativa alla gara in oggetto vengono custoditi in luogo sicuro presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione patrimoniale, sotto la responsabilità del segretario verbalizzante
La seduta si chiude alla ore 17:00 circa.

Letto, confermato e sottoscritto

Presidente (avv. R. di Gennaro)



Componente Commissione (dott. P. Terrosu)



Componente Commissione (dott. M. Portoghese)



Componente Commissione (ing. R. Marca)



Componente Commissione (dott. C. Delussu)



Segretario (dott.ssa T. Soro)



16/04/2010

Procedura Emodinamica		DITTA 1	P.TI
a) Qualità apparecchiature, arredi e dotazioni strumentali accessorie e lavori di completamento dei locali			
	MAX PT. 25		
CRITERI DI VALUTAZIONE			
Caratteristiche tecnico funzionali apparecchiature max pt. 9 di cui:	max pt. 9 di cui:		
a) Cardioangiografo fisso	max pt.3,5	<p>SIEMENS - Mod. Artis zee floor (Angio/Card)</p> <p>Sistema a pavimento perfettamente rispondente alle specifiche di capitolato, completa e di elevatissima qualità, comprensivo di tutti i pacchetti DICOM, kit completo di fantocci e con caratteristiche superiori tra le quali:</p> <p>Tavolo operatorio di grande portata (390kg), integrato nel sistema anticollisione;</p> <p>Arco sottile con sistema anticollisione anche sulla corona, maggiori posizioni di lavoro grazie alla seconda cerniera dell'arco;</p> <p>Sincronizzazione fra flat panel e collimatore (sistema infocus);</p> <p>Pacchetto CARE di riduzione della dose fino al 90% di riduzione della dose rispetto ad un sistema standard garantendo maggiore sicurezza dei pazienti e dagli operatori di sala.</p> <p>Monitor addizionale a colori per altre sorgenti di immagini;</p> <p>Interfaccia grafica Syngo, che facilita l'interscambio delle equipe di lavoro e il trasferimento automatico delle anagrafiche da un sistema all'altro;</p> <p>E' prevista la possibilità di effettuare tele diagnosi e tele assistenza;</p> <p>E' previsto un UPS per mantenere, in caso di mancanza di energia elettrica, l'angiografo sia in scopia che in grafia consentendo agli operatori di finire la procedura senza problemi.</p> <p>SIEMENS - Mod. Axiom Artis U</p> <p>Sistema a pavimento perfettamente rispondente alle specifiche di capitolato, completa e di elevatissima qualità, comprensivo di due monitor ripetitori in sala comando, tutti i pacchetti DICOM, kit completo di fantocci e con caratteristiche superiori tra le quali:</p> <p>Maggiore potenza, 80KW, per procedure praticamente illimitate, e completo di tutti i programmi cardiologici permette l'utilizzo anche per procedure di emodinamica, costituendo vero un backup del cardioangiografo fisso in caso di fermo macchina di quest'ultimo o per urgenze nel caso che la prima sala sia occupata;</p> <p>Ampia profondità dell'arco;</p> <p>Movimenti dell'arco sono motorizzati;</p> <p>Pacchetto CARE di riduzione della dose fino al 90% di riduzione della dose rispetto ad un sistema standard garantendo maggiore sicurezza dei pazienti e dagli operatori di sala;</p> <p>Interfaccia grafica Syngo, che facilita l'interscambio delle equipe di lavoro e il trasferimento automatico delle anagrafiche da un sistema all'altro;</p>	3,5
b) Cardioangiografo mobile	max pt. 1,5		
			1,5

		<p>E' prevista la possibilità di effettuare tele diagnosi e tele assistenza: E' previsto un UPS per mantenere, in caso di mancanza di energia elettrica, l'angiografo sia in scopia che in grata consentendo agli operatori di finire la procedura senza problemi.</p> <p>SIEMENS - Mod. Axiom Sensis XP Lite Apparecchiatura completa, tecnologicamente avanzata, semplice da usare e perfettamente rispondente alle specifiche di capitolato con caratteristiche superiori tra le quali: Medesima interfaccia grafica Syngo, che garantisce la massima interoperabilità fra le apparecchiature, con la possibilità di trasferimento automatico delle anagrafiche da un sistema all'altro; Integrato con il sistema angiografico, con minori ingombri e senza cavi liberi e flottanti con rischi di tranciamento degli stessi durante le manovre di movimentazione o disinfezione della sala.</p>	
c) Poligrafo per emodinamica	max pt 0,5	<p>BARO - Mod. LabSystem PRO Apparecchiatura completa, tecnologicamente avanzata, semplice da usare e perfettamente rispondente alle specifiche di capitolato con caratteristiche superiori tra le quali: 40 canali contro i 32 richiesti, con la possibilità di espansione a 80 canali. Integrazione con i più sofisticati sistemi di mappaggio cardiaco intracoronarico.</p>	0,5
d) Poligrafo	max pt 0,5	<p>ACIST - Mod. Sys. Mod. Acist Cvi: Apparecchiatura completa, tecnologicamente avanzata, semplice da usare e perfettamente rispondente alle specifiche di capitolato.</p>	0,5
e) iniettore ACIST	max pt 0,5	<p>ARROW - Mod. AutoCat2: Apparecchiatura sufficientemente completa e perfettamente rispondente alle specifiche di capitolato</p>	0,5
f) contropulsatore aortico	max pt 0,5	<p>BOSTON SCIENTIFIC - Mod. Ilab: Apparecchiatura completa, tecnologicamente avanzata e perfettamente rispondente alle specifiche di capitolato. Il sistema consente le valutazioni ecocardiografiche intravascolari sia coronariche che periferiche con in più la possibilità di effettuare anche quelle intracardiache durante le procedure PFO e grazie al protocollo DICOM espressamente offerto è possibile memorizzare le immagini nel sistema PACS di archiviazione delle immagini.</p>	0,5
g) ecografo a ultrasuoni intravascolare	max pt 0,5	<p>Apparecchiatura di semplice utilizzo</p> <p>SIEMENS - Modello Accuson X300 Apparecchiatura completa, tecnologicamente avanzata e perfettamente rispondente alle specifiche di capitolato. Il sistema ha la medesima interfaccia grafica Syngo di tutte le apparecchiature SIEMENS, che garantisce la massima interoperabilità fra le apparecchiature, con la possibilità di trasferimento automatico delle anagrafiche da un sistema all'altro. Grazie al protocollo DICOM è possibile memorizzare le immagini nel sistema PACS di archiviazione delle immagini. Apparecchiatura di semplice utilizzo</p>	0,5
h) Ecocardiografo portatile	max pt 0,5	<p>REDI MEDICAL - Mod. Radioanalyser Xpress: Apparecchiatura completa, tecnologicamente avanzata, semplice da usare e perfettamente rispondente alle specifiche di capitolato.</p>	0,5
i) strumento misura resistenze epicardiche	max pt 0,5		0,5

<p>1) Apparecchiature minori</p>	<p>max pt. 0,5</p>	<p>Defibrillatore - ZOLL - Mod. PDMA-9BSN: Sono stati offerti due defibrillatori, uno per sala. Apparecchiatura completa, tecnologicamente avanzata e rispondente pienamente alle specifiche di capitolato con alcune particolarità: onda bifasica ad alta efficacia con potenze di utilizzo inferiori rispetto a quelle delle altre apparecchiature. GE MAC 1600 Apparecchiatura completa, tecnologicamente avanzata, semplice da usare e perfettamente rispondente alle specifiche di capitolato. Segnale Marquette di alta qualità, riconosciuta universalmente. Intuitivo e digitale consente il risparmio di carta con la possibilità di revisione dei tracciati sullo schermo. La tastiera di grado ospedaliero facilita la pulizia e la manutenzione ACT - INSTRUMENTATION LABORATORIES - Mod. GEM PCL PLUS: Apparecchiatura completa, tecnologicamente avanzata, semplice da usare e perfettamente rispondente alle specifiche di capitolato. Sistema a secco molto più pratico e tecnologicamente avanzato anche dal punto di vista della sicurezza degli operatori. Sono state offerte due apparecchiature per garantire la continuità analitica. GE - Mod. Dash 4000: Sono stati offerti due monitor, uno per sala. Apparecchiatura completa, tecnologicamente avanzata, semplice da usare e perfettamente rispondente alle specifiche di capitolato consentendo il monitoraggio dei parametri clinici del paziente anche durante il trasporto all'interno dell'ospedale. GE - Engstrom: Apparecchiatura completa, tecnologicamente avanzata, semplice da usare e perfettamente rispondente alle specifiche di capitolato. Apparecchiatura di elevato grado di sofisticazione, adatto a operare nei reparti di anestesia e rianimazione con funzionamento intuitivo e di facile apprendimento. Stazione di ventilazione e monitoraggio integrati permette di visualizzare costantemente sul display le forme d'onda pressione e flusso persino quando si regolano le impostazioni di visualizzazione dello schermo. Si può mettere il ventilatore in standby e continuare la nebulizzazione ed/o il monitoraggio in caso di necessità.</p>	<p>0,5</p>
<p>b) Qualità dei dispositivi medici e materiale di consumo.</p>	<p>MAX PT 15</p>		
<p>CRITERI DI VALUTAZIONE</p>			
<p>Qualità dei prodotti per le procedure</p>	<p>max pt. 7</p>		
<p>funzionalità e maneggevolezza:</p>	<p>max pt. 4</p>	<p>Sono stati offerti materiali delle primarie case produttrici (Abbott, Boston, Medtronic, CID, Terumo etc) e di case produttrici minori per ogni tipologia di dispositivo. Questo consente di avere a disposizione degli operatori i migliori dispositivi presenti sul mercato sia dal punto di vista della funzionalità sia della maneggevolezza e perfettamente rispondenti alle necessità</p>	<p>4</p>
<p>caratteristiche tecniche:</p>	<p>max pt. 2</p>	<p>Sono stati offerti materiali delle primarie case produttrici (Abbott, Boston, Medtronic, CID, Terumo etc) e di case produttrici minori per ogni tipologia di dispositivo. Questo consente di</p>	<p>2</p>

		avere a disposizione degli operatori i migliori dispositivi presenti sul mercato con caratteristiche tecniche all'avanguardia e perfettamente rispondenti alle necessità.	
dettami della letteratura internazionale.	max pt. 1	I prodotti offerti hanno un'adeguata bibliografia internazionale. La bibliografia presentata è completa.	1
Amplizza e completezza della gamma dei prodotti offerti	max pt. 8	Per ogni tipologia di prodotti consumabili previsti nelle procedure è stata offerta una gamma di prodotti molto ampia e completa, comprendente prodotti delle più importanti case produttrici mondiali (20 differenti aziende), praticamente quanto di meglio si può trovare oggi sul mercato.	8

Allegato n. 2 al verbale del 16/04/2010

Procedura Emodinamica: Valutazione lavori di completamento dei locali

RTI : Medical Spa – Kardia

Soluzione progettuale proposta per il layout (elementi migliorativi):

La soluzione proposta prevede la realizzazione di due sale per la emodinamica più grandi di quelle del progetto proposto dall'amministrazione, ottenute unificando le sale di osservazione ed eliminando i due depositi. Vengono razionalizzati i percorsi sporco/pulito con la realizzazione di due "filtri" di uscita, uno per sala, che consentono di far uscire lo sporco dalle sale direttamente nei corridoi esterni alla zona di attesa di ingresso. La soluzione è valida e migliorativa perché: a) consente l'utilizzo delle due sale con possibilità di ridurre il personale necessario, b) realizza una efficace separazione dei percorsi pulito/sporco, c) perché realizza sale di emodinamica più grandi con migliore possibilità di movimento degli addetti.

Punti 2

Soluzione proposta per le finiture (elementi migliorativi):

La proposta progettuale prevede un sistema di pareti modulari tecnologiche rispondenti ai requisiti di progetto a base di gara. Al punto 2.0 della relazione tecnica B7 il concorrente, come elemento migliorativo, lascia libertà di scelta all'amministrazione fra sei tipi di pannellature, pur indicandone una, che risponde a quanto indicato in progetto, come soluzione proposta.

Punti 2

Soluzione proposta per gli impianti (elementi migliorativi):


La proposta progettuale sostanzialmente non muta quanto previsto in progetto, pur adattando lo schema impiantistico al layout proposto

Punti 0

Soluzione proposta per gli arredi (elementi migliorativi):

La proposta progettuale risponde sostanzialmente a quanto richiesto dal disciplinare e prevede la fornitura aggiuntiva di: n. 4 armadi porta dispositivi, n. 2 barelle ad altezza variabile, n. 2 carrelli per emergenza, ritenuti utili ai fini dell'ottimizzazione delle prestazioni.

Punti 1

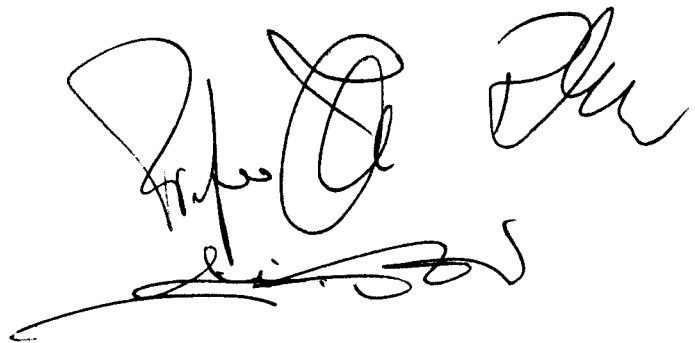

Allegato n. 3 al verbale del 16/04/2010**Procedura Emodinamica: Valutazione Software Refertazione, gestione magazzino e statistiche
RTI : Medical Spa – Kardia**

Il raggruppamento temporaneo di Impresa (RTI) Medical Spa/Kardia offre un sistema gestionale qualitativamente molto buono attraverso la stesura di un progetto di informatizzazione del laboratorio di Emodinamica del reparto di Cardiologia adeguato e completo rispetto ai requisiti richiesti dal bando di gara.

Il sistema gestionale, dovendo trasferire grosse quantità di dati tra le apparecchiature tecnologiche, le workstation di refertazione e i server, risulta adeguatamente supportato dalla infrastruttura di rete proposta (si veda la presenza dello switch a 1Gb offerto [vol 1 fas 25 pag 4]).

La commissione giudica molto positivamente un sistema tollerante ai guasti e agli eventi avversi avente un'architettura del server ridondata e ad alte prestazioni. L'offerta di un server primario e di un server di backup, assieme alla presenza di uno storage RAID consentono, nell'eventualità di guasti, una ripartenza del server di backup senza perdite di dati e in tempo reale. [vol 1 fas 25 pag 31]. Inoltre, la possibilità descritta di garantire il funzionamento autonomo delle workstation di refertazione (nell'eventualità improbabile di indisponibilità completa del server) attraverso la disponibilità delle immagini gestite nell'ultimo mese [Vol 0 pag 33] conferma questo giudizio.

Il modulo Galaxy presentato per la gestione delle fasi di refertazione risulta implementare adeguatamente e in modo completo tutti requisiti richiesti, da quelli relativi all'usabilità e personalizzazione dell'interfaccia utente (si veda la possibilità di ordinare e rendere obbligatori vari campi del referto) a quelli più specifici per le procedure cliniche (si veda la gestione dei vari score o la possibilità di refertare un numero illimitato di lesioni). Il livello di personalizzazione dei dati e la generazione dei referti è giudicato di buon livello.

Il modulo per la gestione delle statistiche risulta altamente personalizzabile dall'utente il quale è in grado di esportare le sedute presenti nel sistema attraverso numerose possibilità di filtering.

Per facilitare la condivisione dei flussi informativi tra i servizi aziendali sarebbe stato ottimo accedere al modulo statistiche senza la necessità di installare il software nella postazione utente, ma dalla documentazione presentata si deduce che il modulo ha un'architettura client server e non (benché non richiesto come requisito) web.

Il RTI presenta un'offerta tecnica che recepisce appieno la volontà della stazione appaltante di avere un sistema per la gestione del laboratorio di Emodinamica calato in un contesto informatico integrato. Si giudica positivamente l'apertura di un sistema in grado di integrarsi con le anagrafiche dei pazienti ricoverati e in grado di recepire in automatico le richieste di esami provenienti dagli altri reparti o dal Centro Unico di Prenotazione fornendo un referto con immagini al Clinical Data Repository aziendale. Viene valutata in maniera positiva anche la possibilità che il materiale gestito nella fase di refertazione induca uno scarico automatico verso il modulo di gestione del magazzino attraverso l'uso di lettori bar code in dotazione con le workstation di refertazione.


Buona anche la predisposizione del sistema mirata all'integrazione con aziende esterne per teleconsulti e secondi pareri [Vol 0 pag 30].


Completo e funzionale il modulo di gestione delle immagini denominato VEPRO Imaging Mediange in grado di lavorare assieme al modulo Galaxy sfruttando appieno le funzionalità dei due monitor delle workstation di refertazione.

Punteggio attribuito 8


www.aslolbia.it

Sede Legale:
Via Caduti del Lavoro, 35
07026 Olbia (OT)
p. iva: 01687160901


Direzione Generale
Staff Direzione Aziendale Via Caduti del
Lavoro, 35
07026 Olbia (OT)
Telefono 0789 552332
Fax: 0789552329
e-mail: dir-generale@aslolbia.it

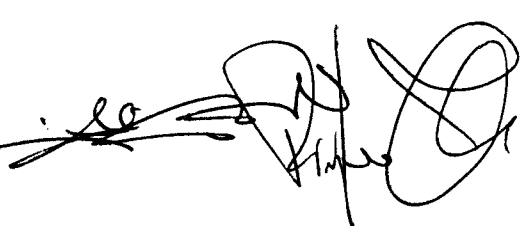
S. I. S. A.
Servizio Informativo Sanitario e Amministrativo
Via Caduti del Lavoro, 35
07026 Olbia (OT)
Telefono 0789 552 -366
Fax: 0789 552 359
e-mail: sisisa@aslolbia.it

Allegato n. 4 al verbale del 16/04/2010**Procedura Emodinamica: Valutazione Qualità della gestione del servizio proposto e dell'assistenza tecnica****RTI : Medical Spa – Kardia**

- Rispondenza alle esigenze del reparto (training e formazione del personale, rete locale di "consulenza", orari di lavoro, varietà e specificità delle tecniche interventistiche offerte etc.): training e formazione del personale completo e soddisfacente, orari di lavoro adeguati, ampia gamma di tecniche interventistiche offerte tali da coprire tutte le esigenze. **punti 4**
- Assistenza tecnica: molto buone le garanzie d'assistenza, on site ed in remoto, per attività (preventive e correttive) svolte direttamente e a mezzo subappaltatori (case madri); rapidi i tempi d'intervento e di soluzione guasto, con alcune apparecchiature in sostituzione in caso di prolungamento dei tempi di riparazione o di necessità di spedizione dell'apparecchiatura a laboratori; il piano degli interventi manutentivi sulle apparecchiature si conforma alle disposizioni legislative vigenti, incluse quelle di sicurezza sugli elettromedicali; adeguato il piano manutentivo dei locali) **punti 3**
- Gestione del magazzino: il sistema gestionale, completamente automatizzato (software GalaxyStore), garantisce una rapida reintegrazione delle scorte, la tracciabilità di tutti i prodotti, l'eliminazione dal magazzino dei prodotti in scadenza almeno quindici giorni prima della scadenza stessa.
Il sistema dà assicurazioni anche in caso di richieste urgenti di materiale non presente nel magazzino di reparto (magazzino di back up in Sassari) **punti 6**
- Tempi di consegna per il ripristino delle scorte sono eccellenti, e il sistema nel suo complesso offre le garanzie sul rispetto di detto risultato. **punti 3**





n. prot. PG/2010/24622

Olbia, 06.05.2010

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Igiene, Sanità e
Dell'Assistenza Sociale
- Servizio Controlli sulle Aziende Sanitarie Locali -
Via Roma, 221
-CAGLIARI -

Oggetto: Controllo preventivo art. 29 comma 1, della L.R. n. 10 del 28.07.2006 – Invio
deliberazione.

Si trasmette, in tre copie debitamente conformizzate, allegate alla presente,
ai sensi dell'art. 29 comma 1, della L.R. n. 10 del 28.07.2006, la deliberazione n. 913 del
29.04.2010 adottata dal Commissario.



Il Commissario
- dott. Giovanni Antonio Fadda -



ASL N. 2 OLBIA	
POSTA IN ARRIVO	
20 MAG 2010	
27366	



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Affari Generali ed Istituzionali

Prot. n. Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale della Sanita'
Prot. Uscita del 17/05/2010
nr. 0011064
Classifica: XV.5.6

Cagliari, 17 MAG 2010



> Al Direttore Generale dell'A.S.L. n° 2
OLBIA

Oggetto: CONTROLLO ATTI ex art. 29 L.R. 28.07.2006, n° 10.

Si trasmette, allegata alla presente, la determinazione relativa alla deliberazione n° 913 del 29/04/2010 trasmessa da codesta Azienda U.S.L. per il controllo ex L.R. n° 10/06.

Il Direttore del Servizio

Dr.ssa Maria Vincis



MI
Dr. F.A. / Resp. Sett. 1/2
Rif.: controllo atti/asi 2 Olbia/anno 2010/Trasmissioni/trasm. 913-29.04.2010.doc

OG-DS-DA
AA. 66.

sep 7. x
sep 17. 6



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Affari Generali ed Istituzionali

Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale della Sanità'
Prot. Uscita del 17/05/2010
nr. 0011062/Det/419
Classifica: XV.5.6

DETERMINAZIONE N.

DEL



Oggetto: Deliberazione n° 913 del 29/04/2010 dell'A.S.L. n° 2 di Olbia

- VISTO** lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA** la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n° 1;
- VISTO** l'art. 29 della Legge Regionale 28 luglio 2006, n° 10 «Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione legge regionale 26 gennaio 1995, n° 5»;
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n° 31;
- VISTO** il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, personale e riforma della Regione n° 31635/119/P del 02/11/2009, con la quale sono state conferite le funzioni di Direttore di Servizio Affari Generali ed Istituzionali presso la Direzione Generale della Sanità alla Dott.ssa Maria Vincis;
- VISTA** la deliberazione n° 913 in data 29/04/2010 dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2 di Olbia, pervenuta in data 07/05/2010;
- VISTE** le relative conclusioni istruttorie del competente Ufficio, in data 17/05/2010;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Servizio Affari Generali ed Istituzionali

DETERMINAZIONE N.

DEL

419

17 MAG 2010

DETERMINA

La deliberazione n° 913 in data 29/04/2010 dell'A.S.L. n° 2 di Olbia avente ad oggetto «Approvazione atti di gara e aggiudicazione definitiva della fornitura in regime di service di beni, lavori e servizi per la gestione delle procedure cliniche del laboratorio di emodinamica dell'unità operativa di cardiologia del presidio ospedaliero di Olbia» è APPROVATA in quanto esente da vizi.

La presente determinazione è comunicata all'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'Art. 21 della L.R. n° 31/98.

Il Direttore del Servizio

Dr.ssa Maria Vincis

MI
Dr. F.A. / Resp. Sett. 1/2

Rif.: controllo atti/asl 2 Olbia/anno 2010/determinazioni/determinazione 913-29.04.2010.doc

